PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
2950/VI.EB/2026

Pemilik *Costumer*	:	RS. William Booth Semarang
Alamat *Address*	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
Tanggal Kalibrasi *Date of Calibration*	:	25 Juni 2026

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama *Name*	:	Autoclave
Merk *Manufacture*	:	Mednif
Tipe *Type*	:	LS-B.50L
Nomor Seri *Serial Number*	:	220.V50.8KN
Tempat Kalibrasi *Place of Calibration*	:	CSSD
Tanggal Diterbitkan *Date of Issued*	:	2 Juli 2026
Keterangan *Remarks*	:	Laik Pakai

PT EKSGON BROTHER

PT EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Kalibrasi AutoClave

No.Sertifikat : 2950/VI.EB/2026

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS. William Booth Semarang
2. Merek : Mednif
3. Model/Tipe : LS-B.50L
4. No. Seri : 220.V50.8KN

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : CSSD
2. Tanggal : 25 Juni 2026

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24,065 °C
2. Kelembaban Relatif : 56,5 %RH

D. Alat yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer : Rigel/288/38H-0817 (Tertelusur ke Standart International)
2. Thermohygrometer : HTC/Clock/- (Tertelusur ke Standart International)
3. Data Loger : HTI/HT-9815/2021100016447 (Tertelusur ke Standart International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat


Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
Switch On Off	Baik	Baik	-
Panel Switch	Baik	Baik	-
Indikator Suhu	Baik	Baik	-
Indikator Tekanan Chamber	Baik	Baik	-
Temperatur Adjuster	Baik	Baik	-
Regulator Tekanan	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Autoclave

Setting Alat	Date and Time (UTC+07:00)	Channel 1 Probe Temperature (°C)
134°C	14:53:52	133,16
	14:54:02	133,49
	14:54:52	133,69
	14:55:52	133,90
	14:56:02	134,13
	14:56:52	134,49
	14:57:02	134,66
	14:57:52	133,99
	14:58:02	133,48
	14:58:52	132,99

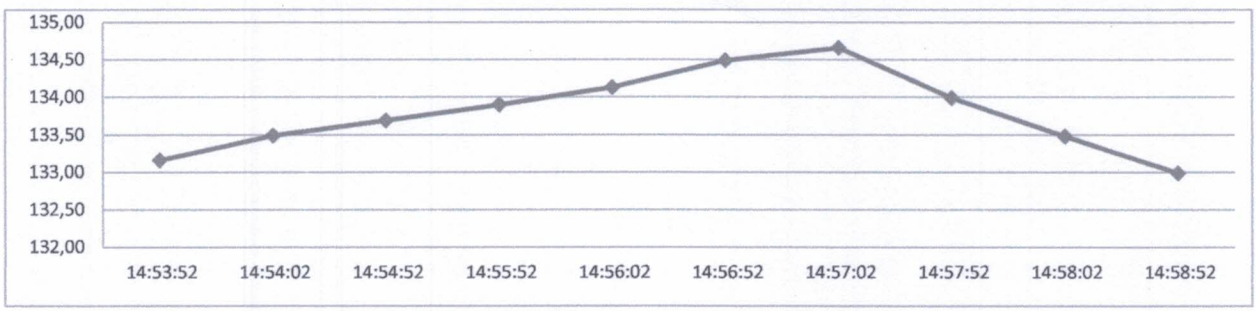

H. Keterangan

1. Alat ini diuji mengunakan metode pengujian MK-06-EB-2022

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK-06-EB-2022 yang merujuk ke Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Permenkes Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id